


Schemat produkcji wina

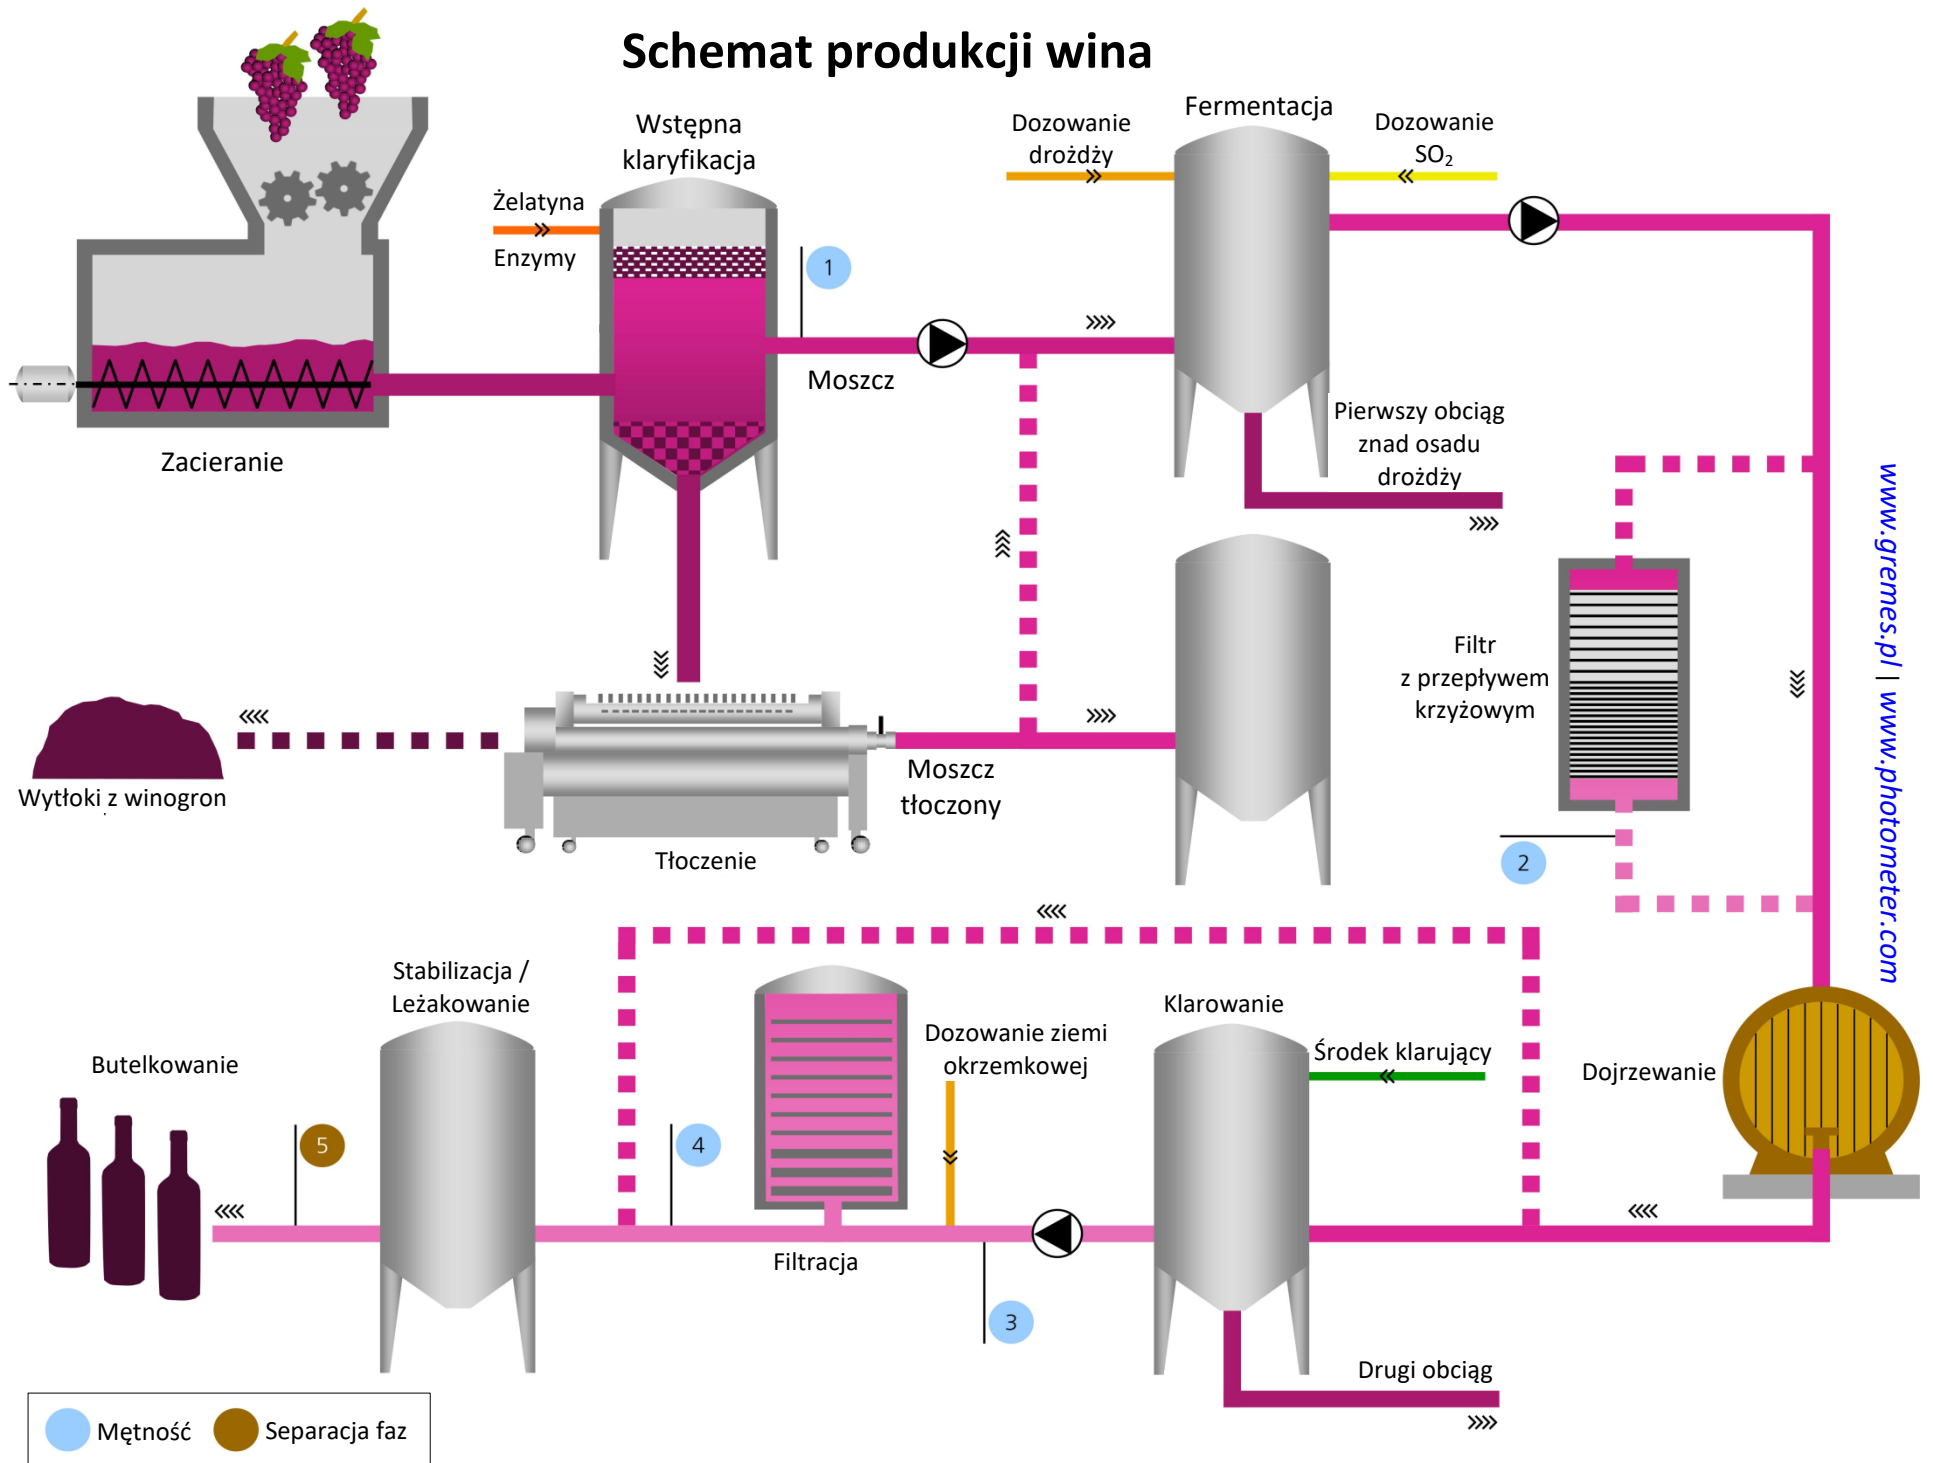

www.gremes.pl | www.photometer.com

Nazwa urządzenia pomiarowego	Nr na schemacie	Rodzaj pomiaru
TurbiGuard	1	Mętność moszczu
TurBiScat 90°	2	Mętność – monitoring procesu filtracji wina za filtrem z przepływem krzyżowym
TurBiScat / TurbiGuard / PhaseGuard T	3	Mętność przed dozowaniem ziemi okrzemkowej
TurBiScat 90/25°	4	Mętność – monitoring procesu filtracji wina za filtrem (np. filtrem ze złożem okrzemkowym)
PhaseGuard C	5	Separacja faz wina / woda

GREMES

Analizatory procesowe i laboratoryjne

ul. Ptasia 24, 59-700 Bolesławiec
tel.: 71 75 75 728 | faks: 71 75 75 729
kom.: +48 694 19 88 19 | 602 29 30 81 | 508 259 369
e-mail: biuro@gremes.pl

www.gremes.pl | www.photometer.com